


## HPLC of 88-82-4

### 色谱图和结果

#### 进样信息

进样名称:	HPLCof88-82-4	运行时间 (min):	30.00
瓶号:	1	进样量:	10.00
进样类型:	未知	通道:	UV_VIS_2
校准级别:		波长:	254.0
仪器方法:	HPLCof88-82-4	带宽:	4
处理方法:	新的处理方法	稀释因子:	1.0000
进样日期时间:	2018/03/06 16:20	样品重量:	1.0000

#### 色谱图

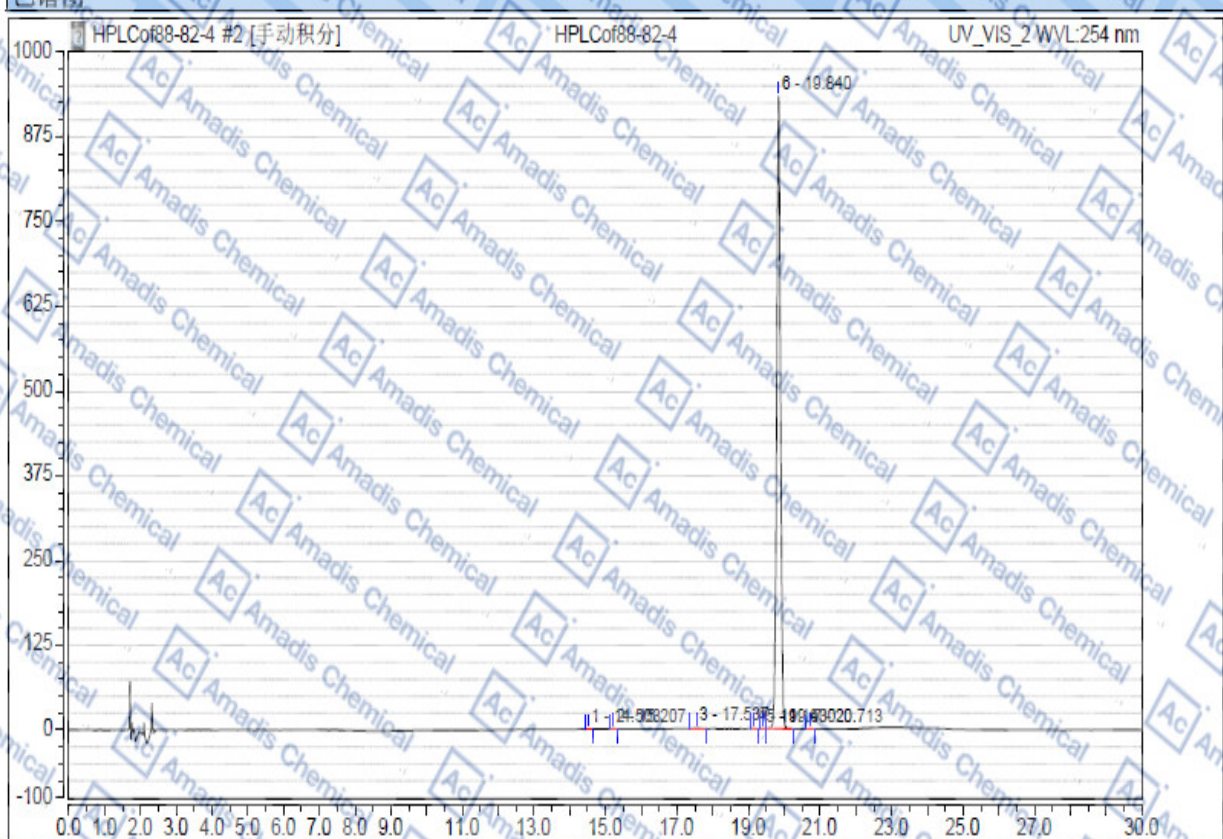

#### 积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	不对称度 (EP)	塔板数 (EP)
1		14.503	0.035	0.424	0.03	1.24	264630
2		15.207	0.100	1.349	0.09	1.06	317146
3		17.537	0.181	1.353	0.15	1.56	187616
4		19.153	0.042	0.421	0.04	1.09	217948
5		19.400	0.024	0.274	0.02	0.90	237609
6		19.840	116.639	932.116	99.63	1.00	163067
7		20.713	0.048	0.392	0.04	1.47	201841
总和:			117.069	936.330	100.00	8.30	

\* if you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)