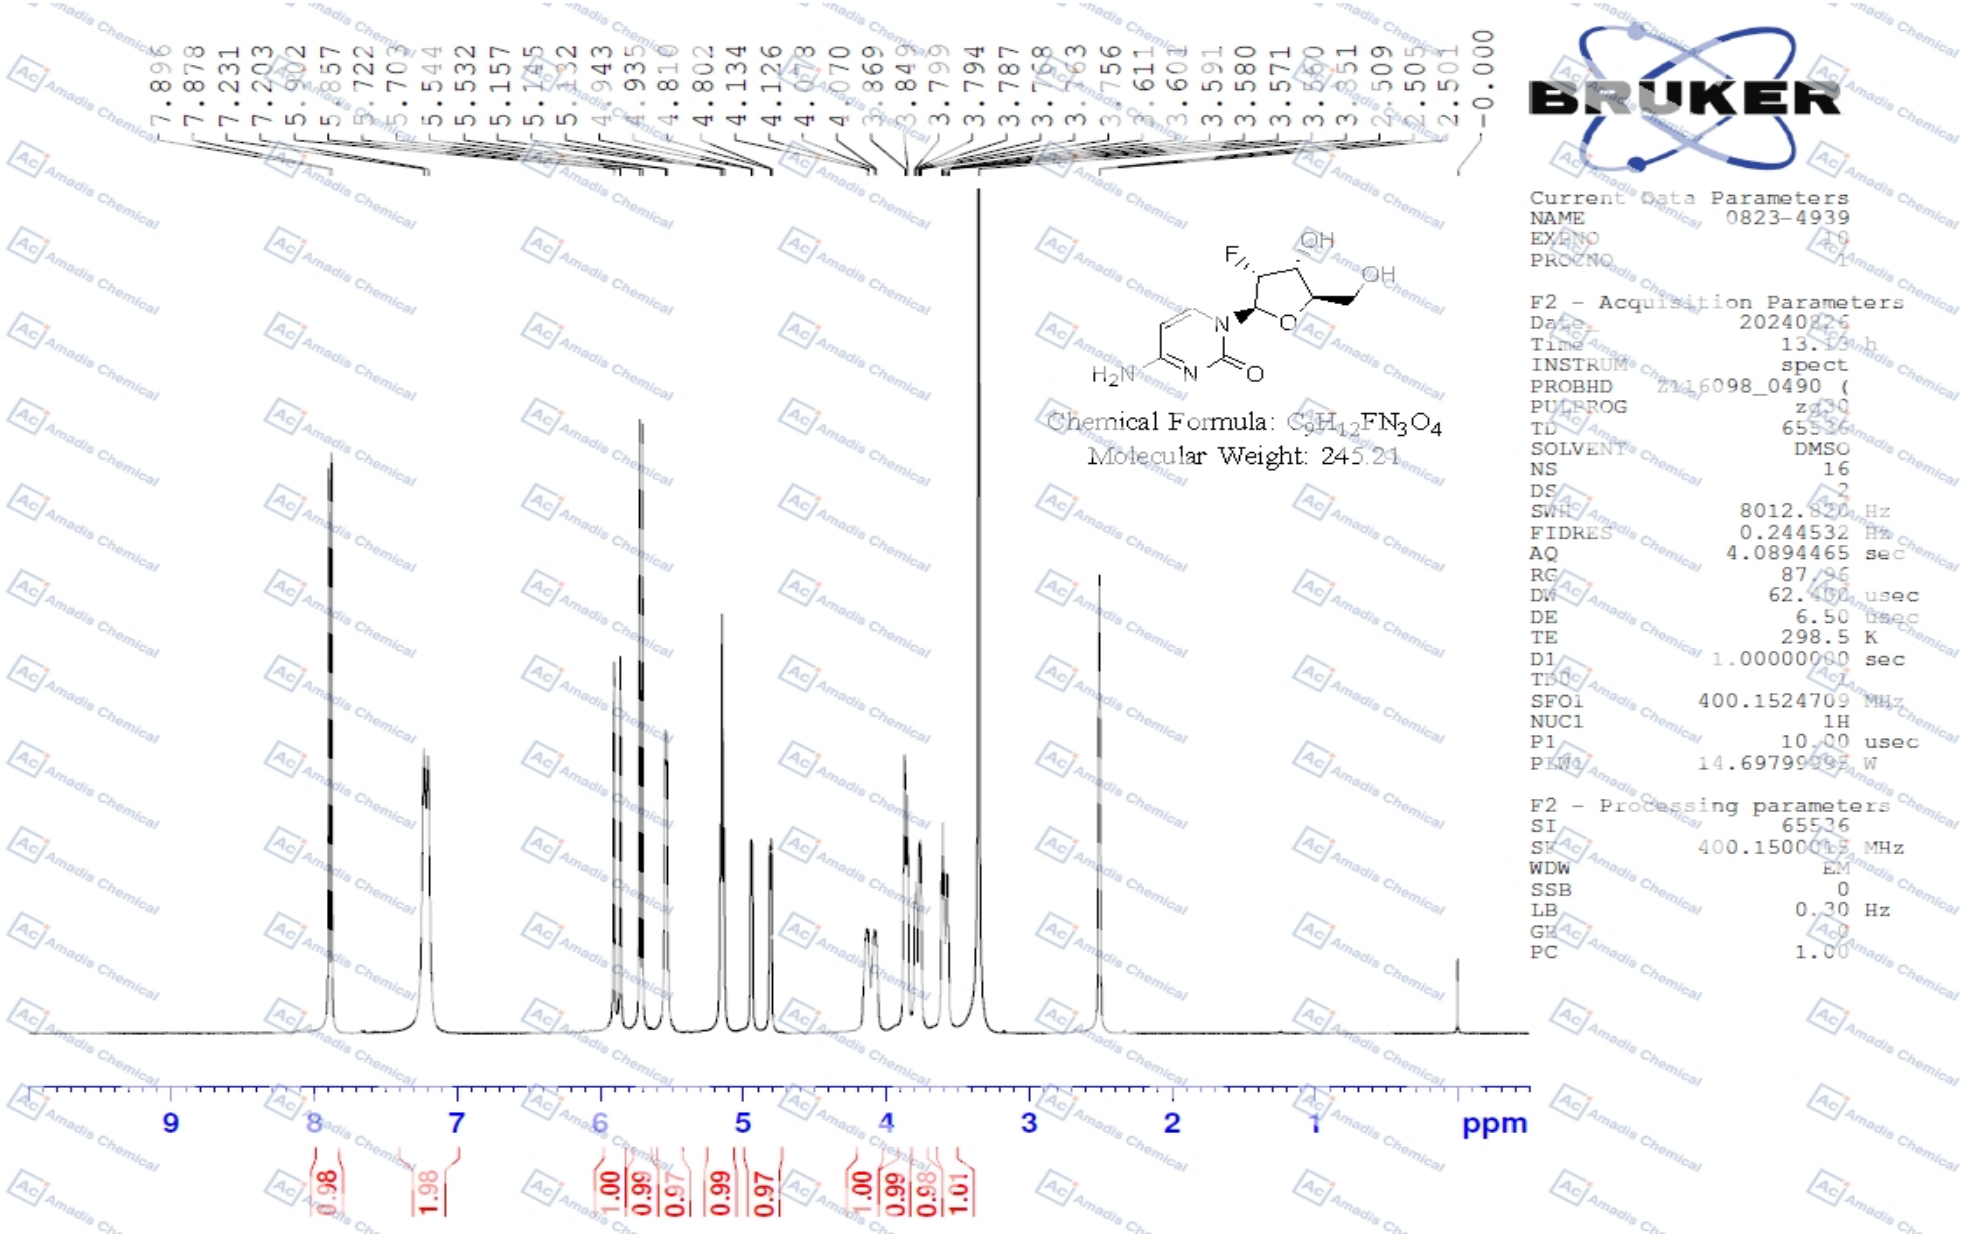

BRUKER

Current Data Parameters
NAME 0823-4939
EXPNO 10
PROCNO 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_ 20240226
Time 13.10 h
INSTRUM spect
PROBHD Z116098_0490 (
PULPROG zg30
TD 65536
SOLVENT DMSO
NS 16
DS 2
SWH 8012.820 Hz
FIDRES 0.244532 Hz
AQ 4.0894465 sec
RG 87.96
DW 62.400 usec
DE 6.50 usec
TE 298.5 K
D1 1.00000000 sec
TD0 1
SFO1 400.1524709 MHz
NUC1 1H
P1 10.00 usec
PLW1 14.69799995 W

F2 - Processing parameters
SI 65536
SF 400.1500015 MHz
WDW EM
SSB 0
LB 0.30 Hz
GB 0
PC 1.00

*For laboratory or manufacturing use only,not for drug,food and household use.