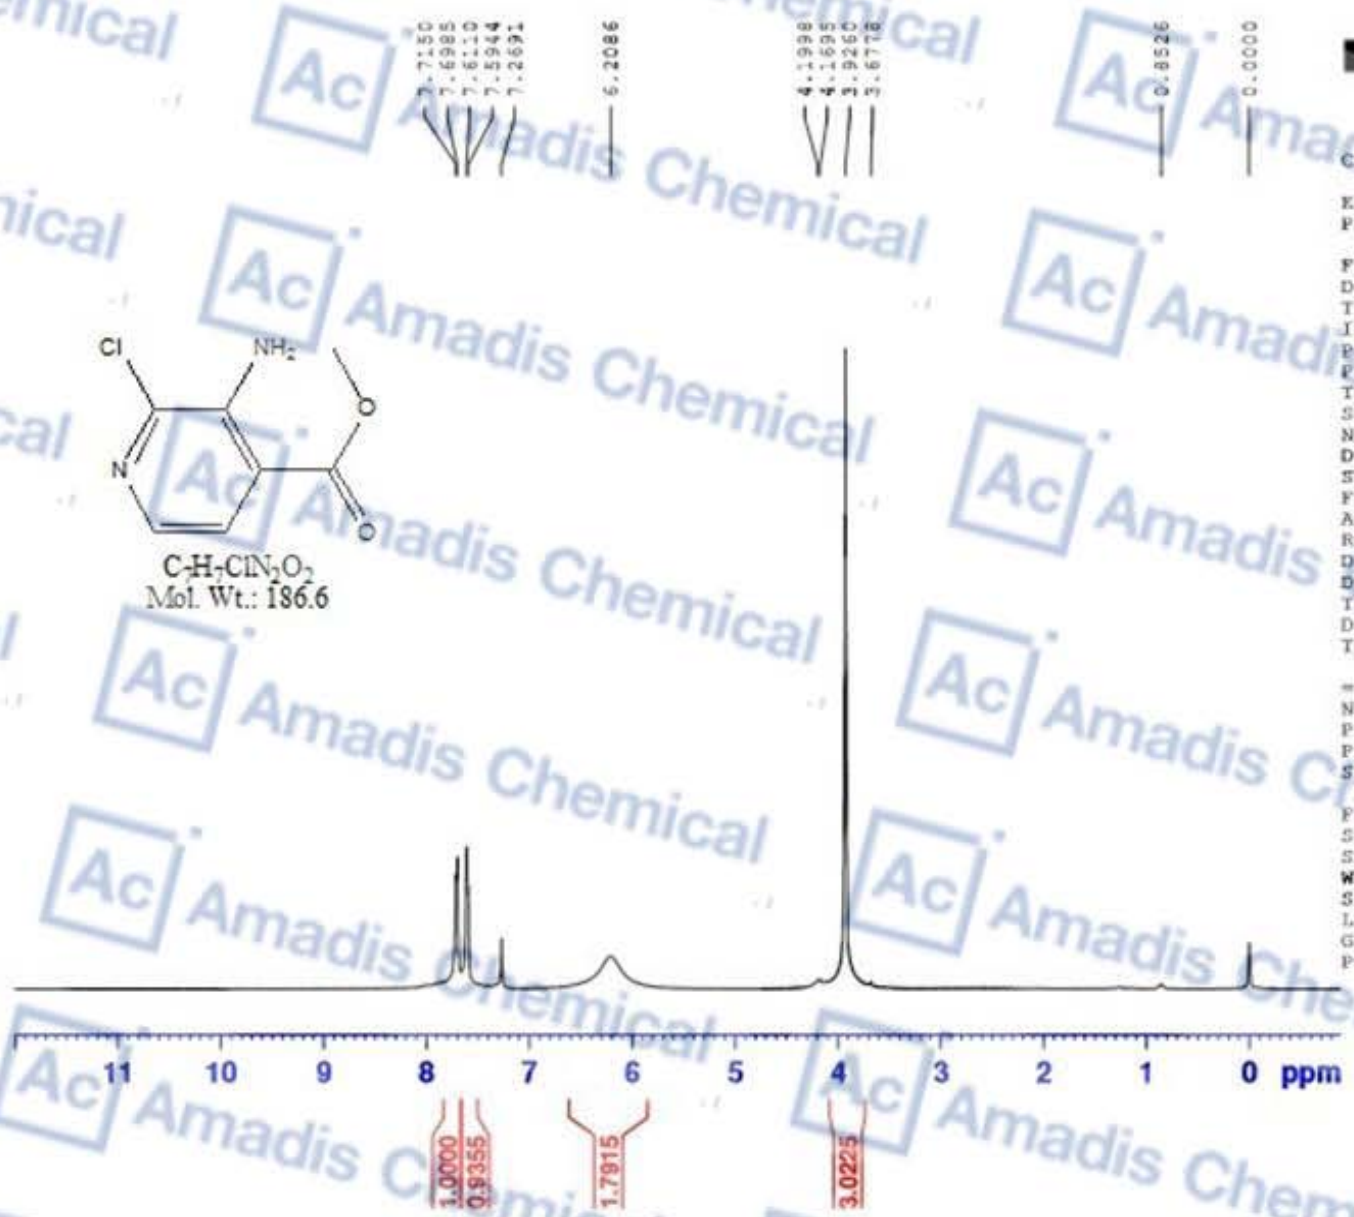

BRUKER

Current Data Parameters

EXPNO	1
PROCNO	1

F2 - Acquisition Parameters

Date_	20160706	
Time	11.31	
INSTRUM	av300	
PROBHD	5 mm PABBO BB/	
PULPROG	zg30	
TD	32768	
SOLVENT	CDCl3	
NS	16	
DS	2	
SWH	5995.204	Hz
FIDRES	0.182959	Hz
AQ	2.7329011	sec
RG	362	
DW	83.400	usec
DE	6.00	usec
TE	296.8	K
D1	2.50000000	sec
TD0	1	

======== CHANNEL f1 ========

NUC1	1H	
P1	10.00	usec
PL1	-2.73	dB
SFO1	300.1318530	MHz

F2 - Processing parameters

SI	16384	
SF	300.1300041	MHz
WDW	EM	
SSB	0	
LB	0.30	Hz
GB	0	
PC	1.40	