


LCMS of 1009298-09-2

操作者 : 序列行 : 4
 仪器 : 仪器 1 位置 : P1-E-03
 进样日期 : 2018/7/16 11:09:21 进样次数 : 1
 进样量 : 5.000 µl
 采集方法 : D:\SAMPLE TEST\JIANCE.M
 最后修改 : 2018/6/11 8:45:49
 分析方法 : D:\SAMPLE TEST\洗脱PM.M
 最后修改 : 2018/7/16 13:49:39
 (调用后修改)


当前色谱图

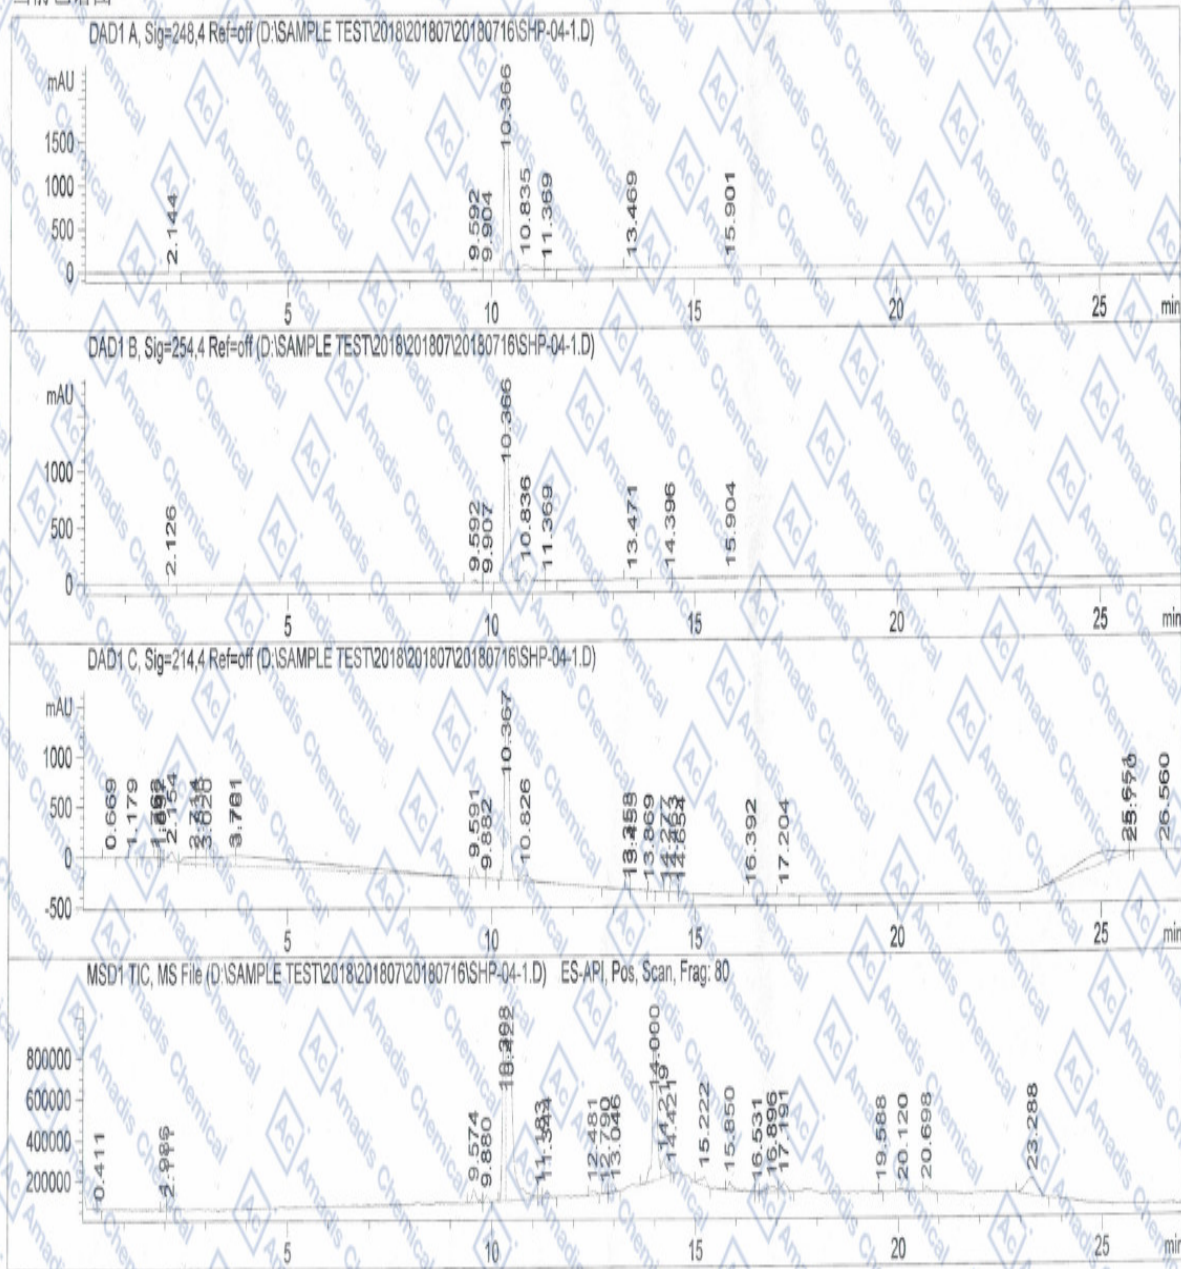

操作者 :
仪器 : 仪器 1
进样日期 : 2018/7/16 11:09:21
采集方法 : D:\SAMPLE TEST\JIANCE.M
最后修改 : 2018/6/11 8:45:49
分析方法 : D:\SAMPLE TEST\洗脱PM.M
最后修改 : 2018/7/16 13:49:39
(调用后修改)

序列号 : 4
位置 : F1-E-03
进样次数 : 1
进样量 : 5.000 μ l

MS Spectrum

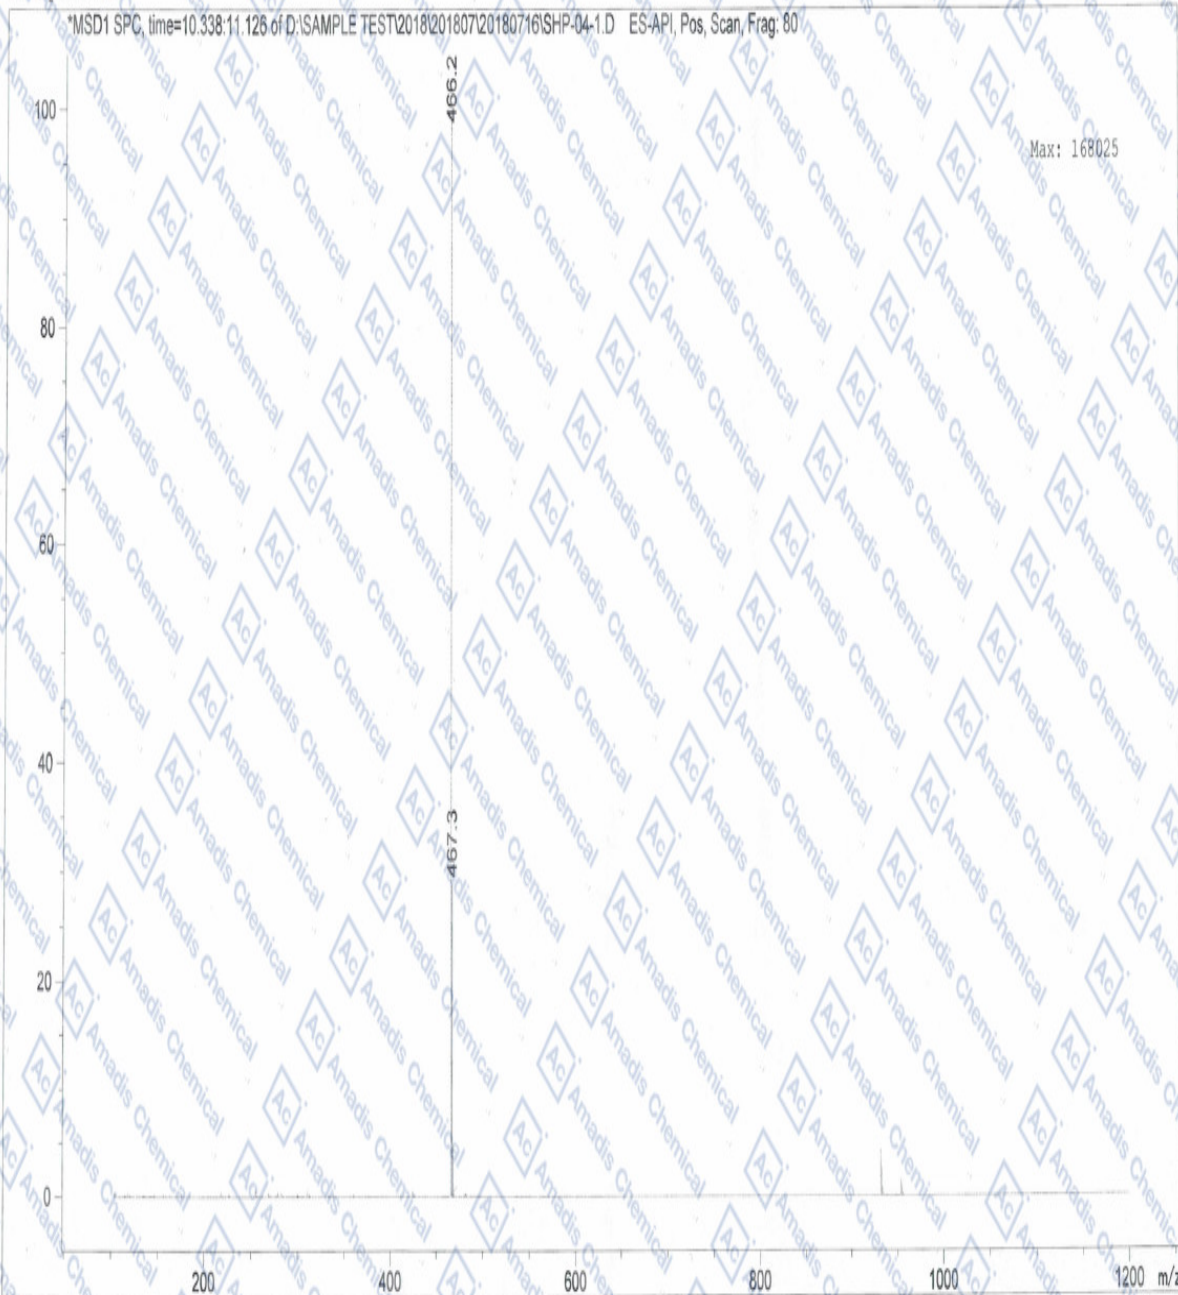

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com