


HPLC of 42074-68-0

色谱图和结果

进样信息			
进样名称:	1031-1143	运行时间 (min):	15.00
瓶号:	RD2	进样量:	2.00
进样类型:	未知	通道:	UV_VIS_1
校准级别:		波长:	220.0
仪器方法:	1031-1143	带宽:	n.a.
处理方法:	新的处理方法	稀释因子:	1.0000
进样日期/时间:	2019/11/01 16:21	样品重量:	1.0000

色谱图

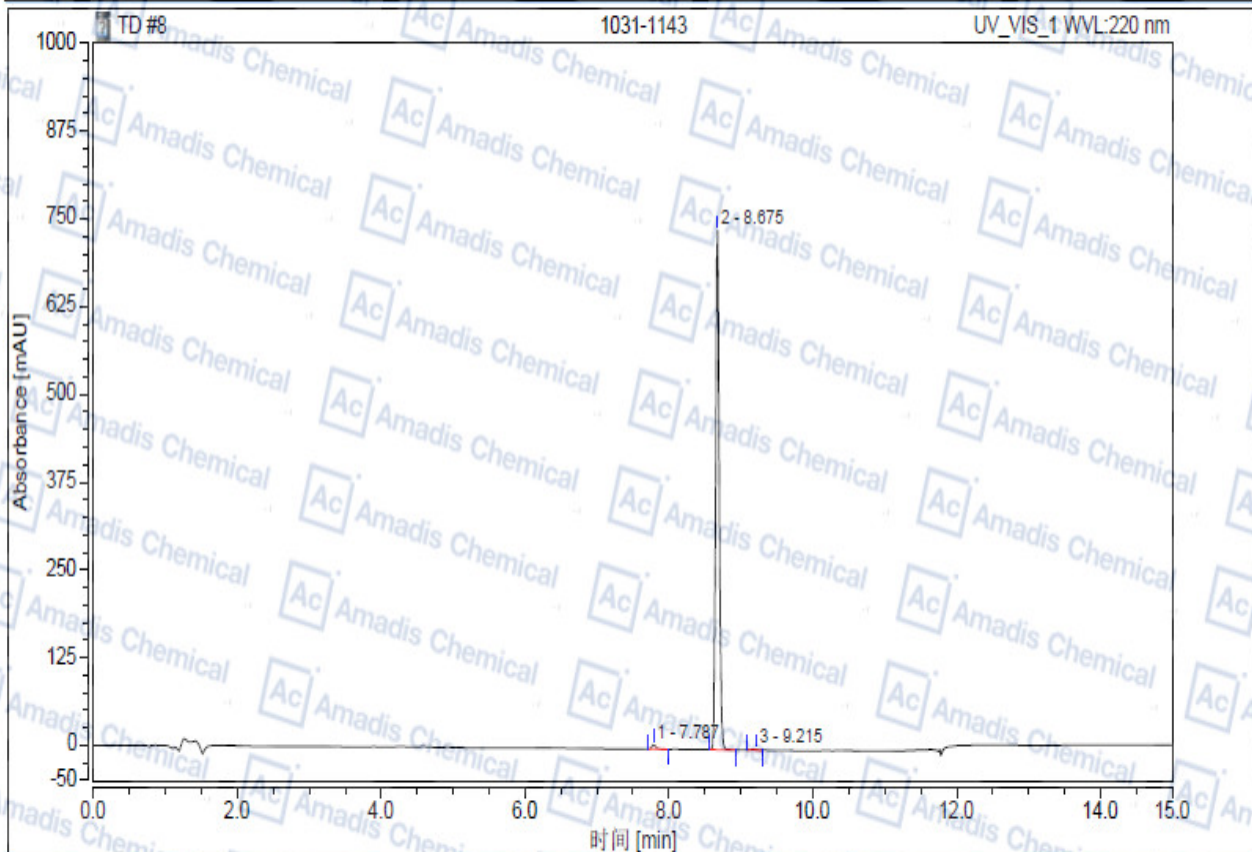

积分结果							
序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	相对峰高 %	样品量 n.a.
1		7.787	0.401	6.246	0.94	0.84	n.a.
2		8.675	42.158	739.245	98.82	99.01	n.a.
3		9.215	0.103	1.110	0.24	0.15	n.a.
总和:			42.663	746.602	100.00	100.00	

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com