


HPLC of 120511-73-1

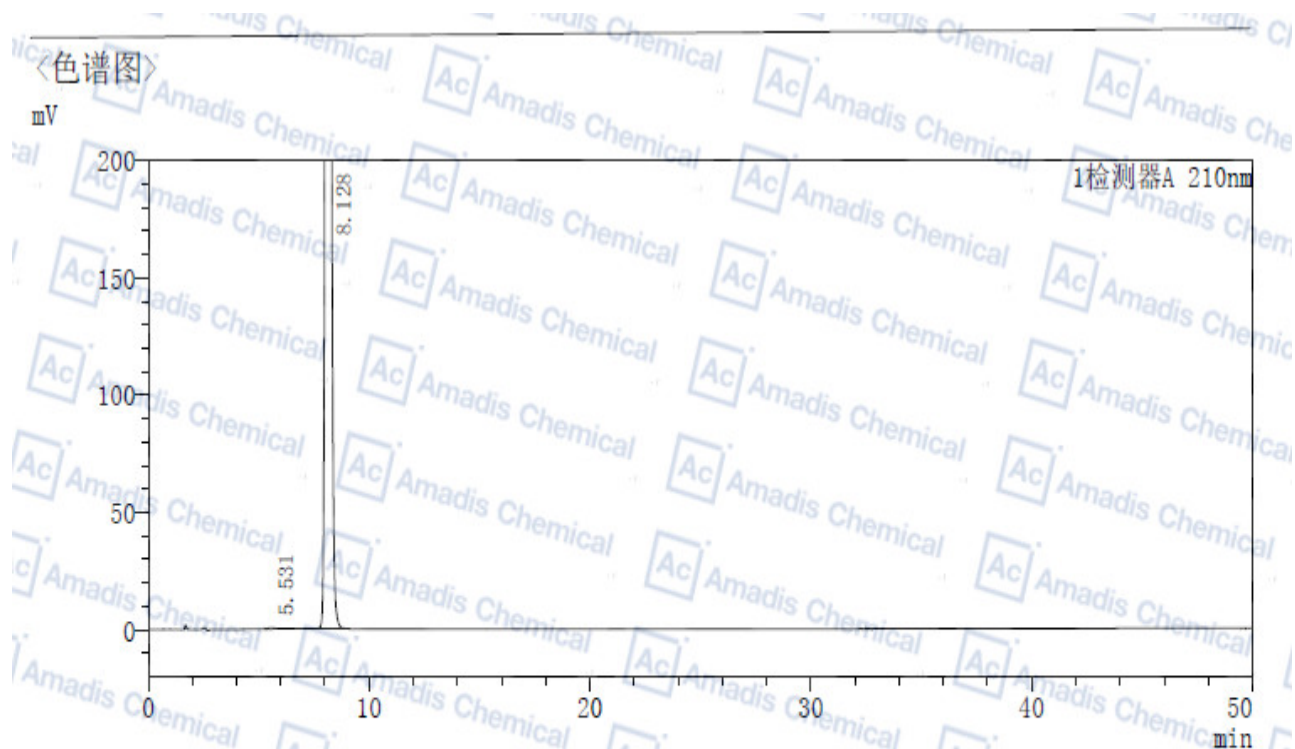

<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	拖尾因子	理论塔板数(USP)	分离度(USP)
1	5.531	5048	353	0.036	1.392	3280	--
2	8.128	13987793	1028670	99.964	1.174	8161	6.963
总计		13992841	1029023	100.000			

*For R&D use only

*if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com