


HPLC of 12051-35-3

自动标尺色谱图

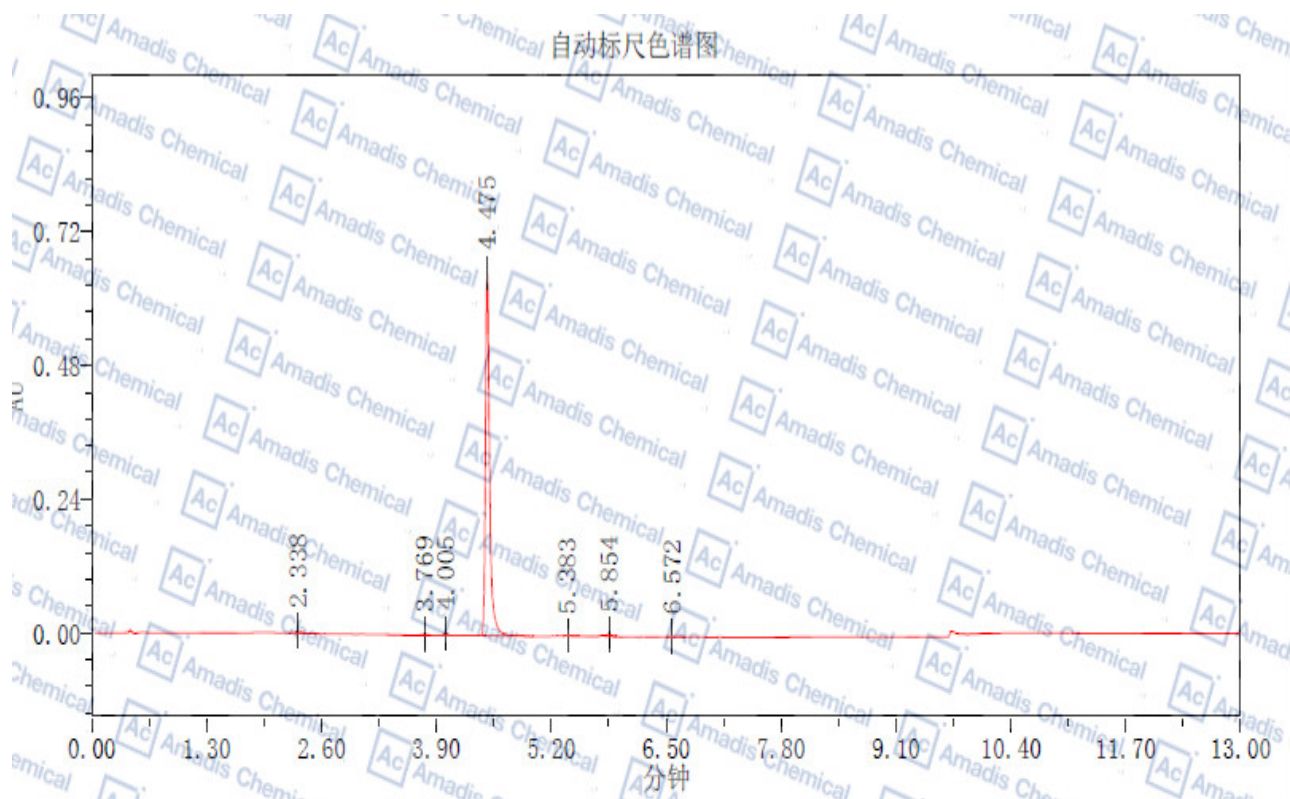

峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	2.338	20439	4831	0.92			
2	3.769	7302	1779	0.33			
3	4.005	15387	4482	0.70			
4	4.475	2152047	652675	97.31			
5	5.383	4796	1400	0.22			
6	5.854	9056	3075	0.41			
7	6.572	2590	620	0.12			

*For R&D use only

*if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com