


HPLC of 368-78-5

自动标尺色谱图

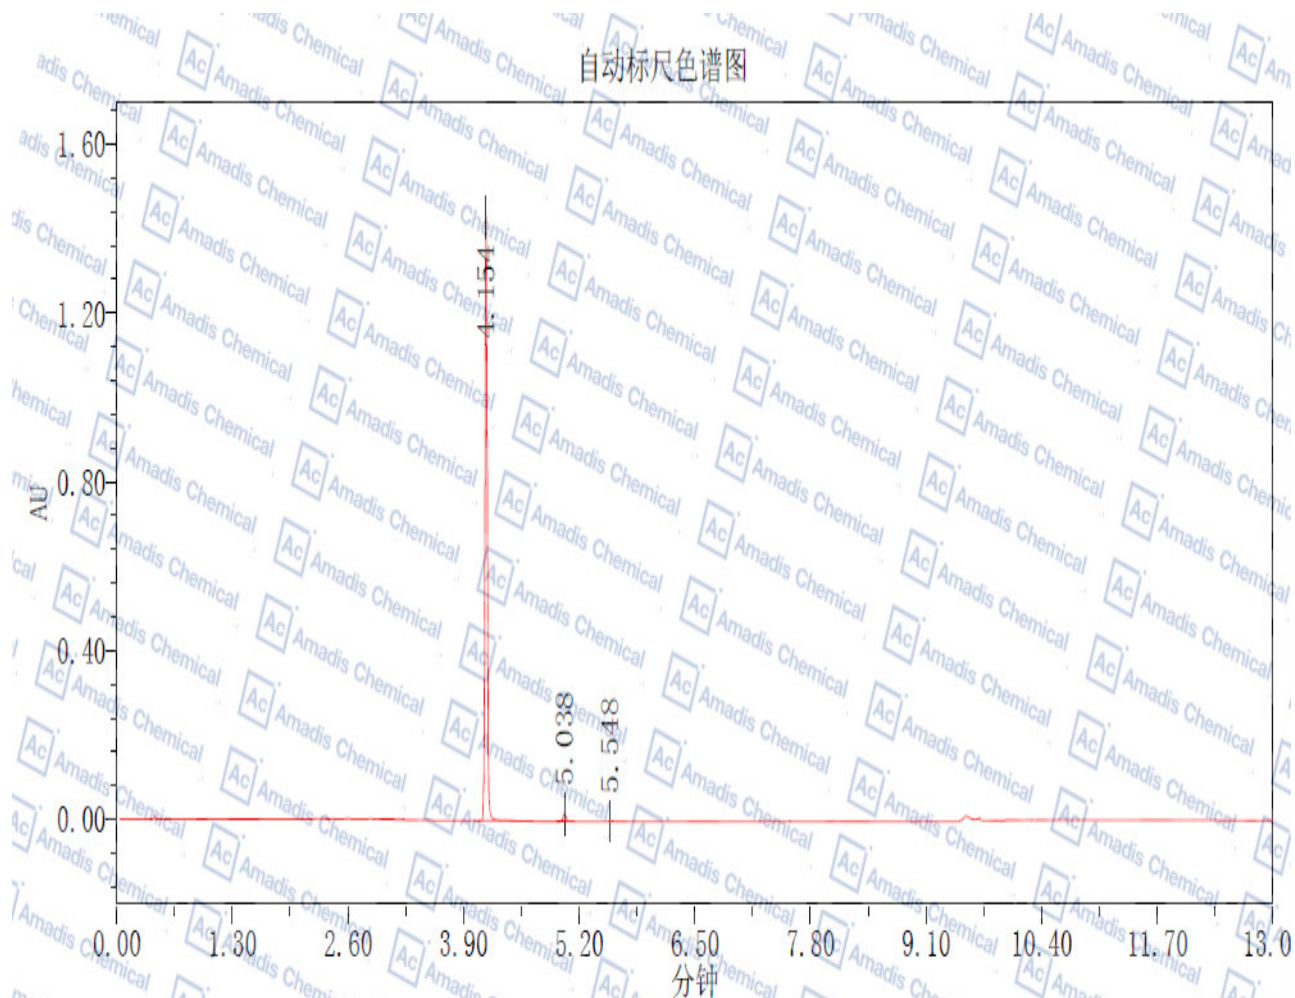

峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	4.154	2536324	1432851	98.28			
2	5.038	42650	18593	1.65			
3	5.548	1626	1084	0.06			

*For R&D use only

*if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com