


HPLC Of 540737-29-9

采集方法 : D:\Chem32\1\Data\tetrandone\TEST 2017-06-05 08-47-58\HPLC.M
 最后修改 : 2017/6/5 9:16:51 : 系统
 分析方法 : D:\Chem32\1\Methods\WASH.M
 最后修改 : 2017/6/5 14:12:19 : 系统
 调用后修改

附加信息: 峰被手动积分
 VWDI.A, Wavelength=254 nm (ItranoVTEST12017-06-05 08-47-38\OnlineEdited61.D)

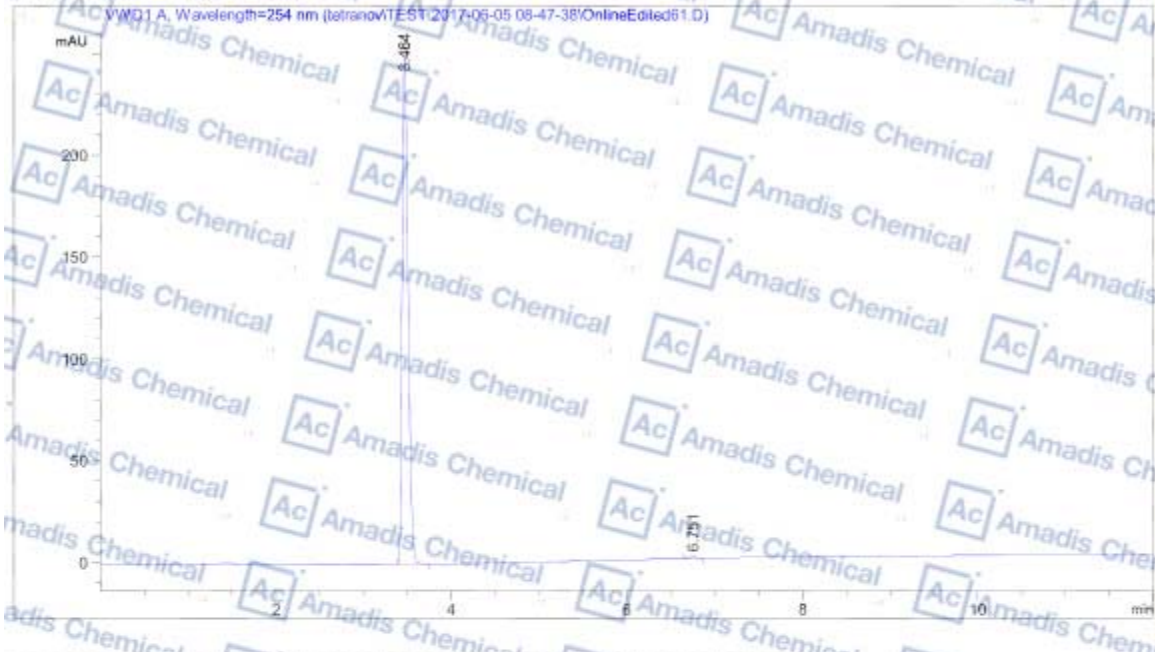

面积百分比报告

排序 信号
 乘积因子 1.0000
 稀释因子 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号1: VWDI.AC Wavelength=254 nm

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	3.464	BB	0.0714	11826	249.36011	99.6577
2	6.451	BB	0.0595	3.99057	1.02301	0.3423

总量: 11865.70883 250.38312

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com