
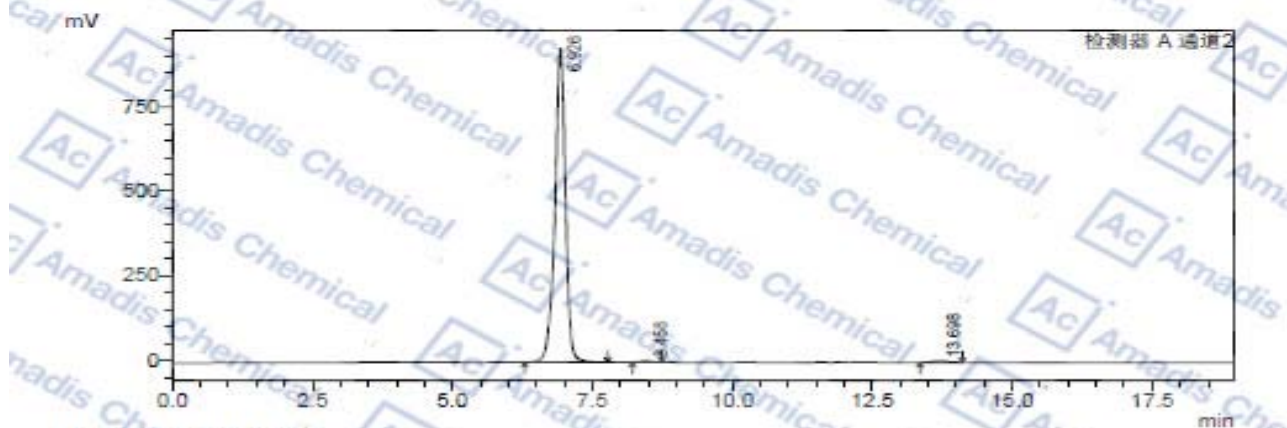


HPLC of 78593-33-6

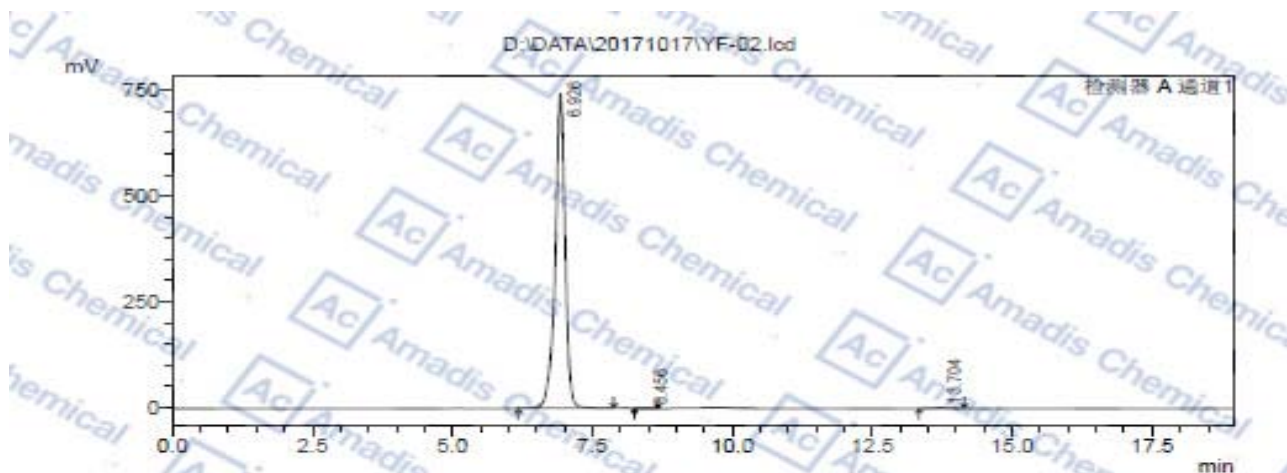

1 检测器 A 通道1/280nm
2 检测器 A 通道2/254nm

峰表

峰#	保留时间	面积	高度	面积 %	高度 %
1	6.926	9229301	744693	99.546	99.874

峰#	保留时间	面积	高度	面积 %	高度 %
2	8.456	6924	611	0.075	0.082
3	13.704	35211	1822	0.380	0.244
总计		9271436	747127	100.000	100.000

峰表

检测器 A Ch2 254nm

峰#	保留时间	面积	高度	面积 %	高度 %
1	6.926	12226383	927865	98.846	99.044
2	8.458	60918	4864	0.493	0.519
3	13.698	81816	4090	0.661	0.437
总计		12369118	936820	100.000	100.000

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com