


HPLC of 1593543-00-0

采集人 : Administrator
 进样体积 : 20 uL
 数据文件名 : YZB-SSR-29631-HPLC.lcd
 方法文件名 : 方法1.lcm

<色谱图>

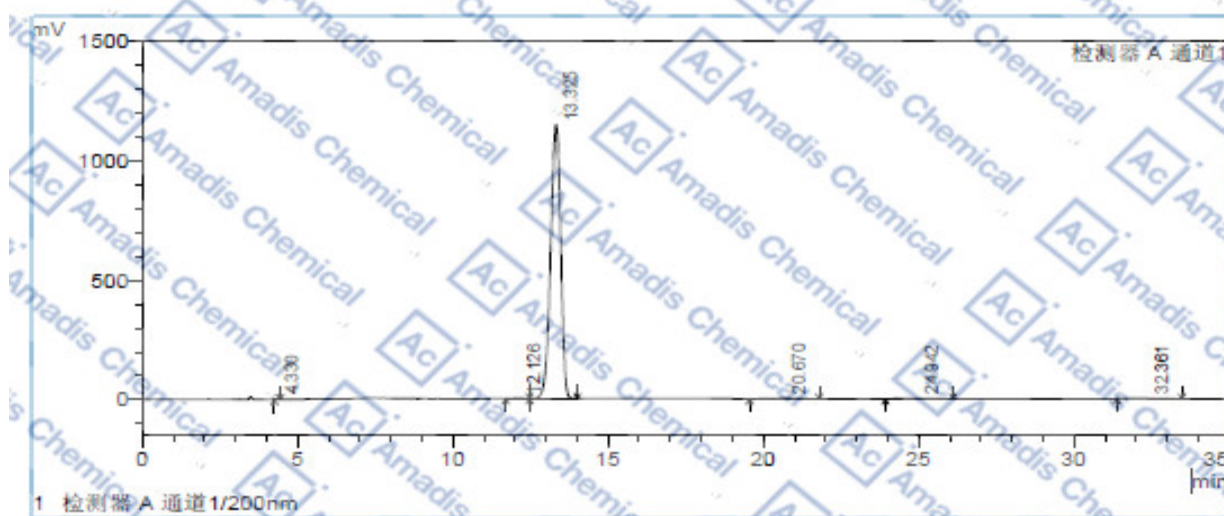

峰表

检测器 A, Ch1 200nm

峰#	保留时间	高度	高度 %	面积	面积 %
1	4.330	391	0.034	2133	0.008
2	12.126	8135	0.271	66606	0.252
3	13.325	1146284	99.061	25881824	98.069
4	20.670	2793	0.241	156848	0.594
5	24.942	2503	0.216	149585	0.567
6	32.361	2038	0.176	136149	0.516
总计		1157144	100.000	26398146	100.000

* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com