

## HPLC of 1225497-78-8



### 进样综合报告 报告


用户名称: System

项目名称: Defaults

#### 样品信息

样品名称:	Rigosertib	采集者:	System
样品类型:	未知	采集时间:	2019-3-29 16:59:20 CST
瓶号:	1:A,5	采集方法组:	新建梯度90_10
进样次数:	1	处理日期:	2019-3-29 17:15:29 CST
进样体积:	2.00 ul	处理方法:	Rigosertib_梯度
运行时间:	15.0 Minutes	通道名称:	W2996 214.0nm-1.2
样品组名称:	Rigosertib	处理通道注释:	W2996 PDA 214.0 纳米 (于 1.2)

自动标尺色谱图

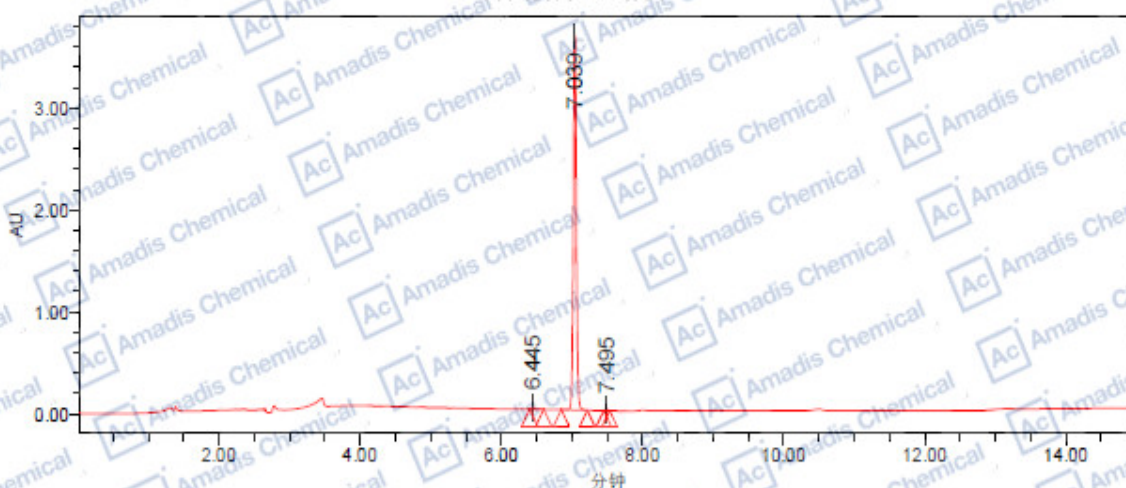

SampleName Rigosertib; Vial 1:A,5; Injection 1; Channel W2996 214.0nm-1.2; Date Acquired 2019-3-29 16:59:20 CST

处理通道: W2996 PDA 214.0 纳米 (于 1.2)

	处理通道	保留时间 (分钟)	面积	% 面积	峰高
1	W2996 PDA 214.0 纳米 (于 1.2)	6.445	70341	0.83	18567
2	W2996 PDA 214.0 纳米 (于 1.2)	7.039	11148382	99.20	3440820
3	W2996 PDA 214.0 纳米 (于 1.2)	7.495	19250	0.17	6724

\* If you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)