


HPLC of 615-94-1

色谱图和结果

进样信息

进样名称:	0506-763	运行时间 (min):	20.00
瓶号:	8	进样量:	10.00
进样类型:	未知	通道:	UV_VIS_1
校准级别:		波长:	280.0
仪器方法:	0506-763	带宽:	4
处理方法:	新的处理方法	稀释因子:	1.0000
进样日期/时间:	2019/05/07 13:07	样品重量:	1.0000

色谱图

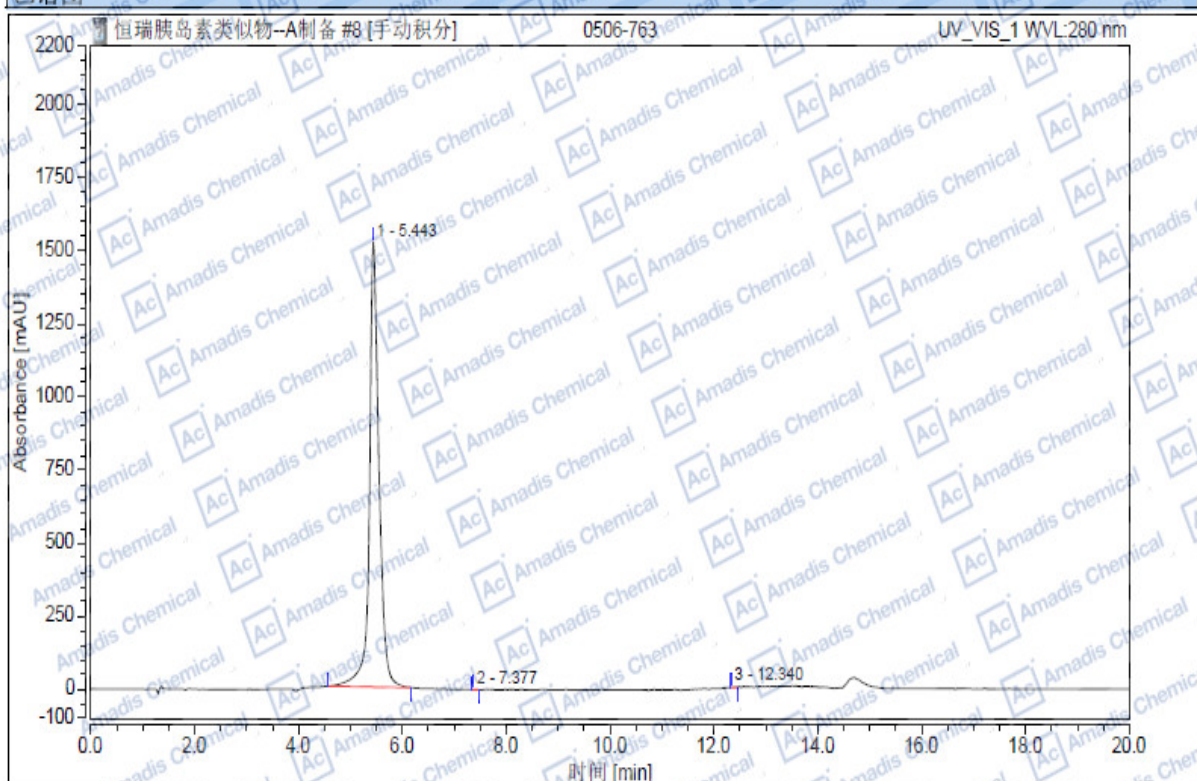

积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	相对峰高 %	样品量
1		5.443	325.335	1523.017	99.92	99.78	n.a.
2		7.377	0.126	1.154	0.04	0.08	n.a.
3		12.340	0.138	2.130	0.04	0.14	n.a.
总和:			325.600	1526.301	100.00	100.00	

* if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com